



Fig.1.1.1. Tampon refolosibil pentru recoltarea exudatului faringian sau a secrețiilor purulente



Fig.1.1.2. Tampon de unică folosință pentru recoltarea exudatului faringian sau a secrețiilor purulente



Fig.1.1.3. Recoltarea exudatului faringian cu tampon de unică folosință

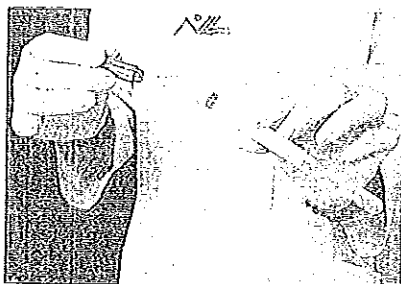


Fig.1.1.4. Final recoltare exudat faringian (introducere tampon în recipientul steril de unică folosință)

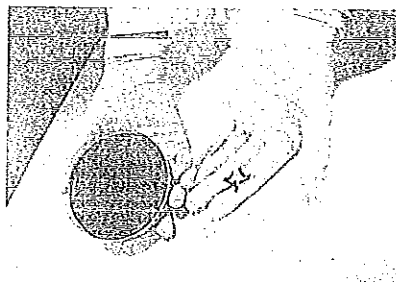


Fig.1.1.5. Mediu de cultură (agar-sânge) pentru examenul bacteriologic al secrețiilor faringiene sau purulente



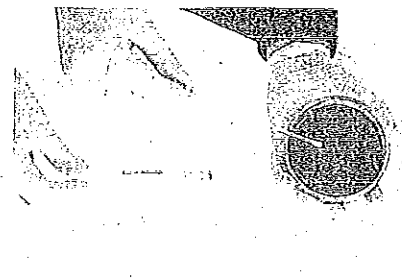


Fig.1.1.6. Descărcarea tamponului cu secreție faringiană pe mediul de cultură

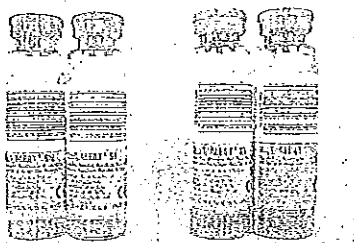

a)  
b)  
Fig.1.4.1. Medii de cultură pereche  
pentru recoltarea hemoculturii la adulți  
cu antibioticoterapie anterioară:  
a) absentă; b) prezentă-mediul FAN



a)  
b)  
Fig.1.4.2. Medii de cultură pereche pentru  
recoltare hemocultură la copii:  
a) aerob; b) anaerob și LCR



Fig.1.4.3. Pregătirea mediilor pentru  
recoltare: timpul 1

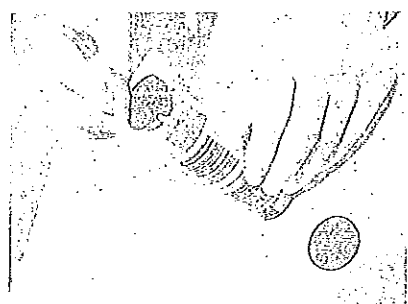


Fig.1.4.4. Pregătirea mediilor pentru recoltare:  
timpul 2

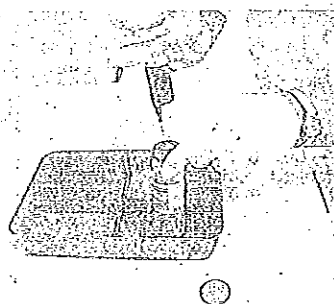


Fig.1.4.5. Însămănțarea mediului cu sângele  
recoltat

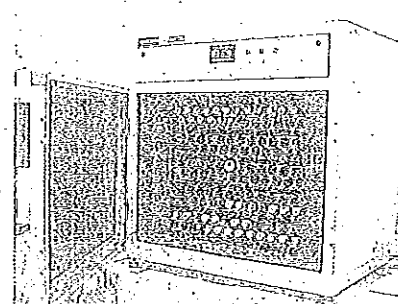


Fig.1.4.6. Aparatul BacTAlert-incinta de  
procesare inițială




Fig.1.5.1. Pozitia asistentei 1 si a pacientului  
(in sezut) pentru rahicenteza



Fig.1.5.2. Pozitia asistentei 2 si a pacientului  
(in sezut) pentru rahicenteza

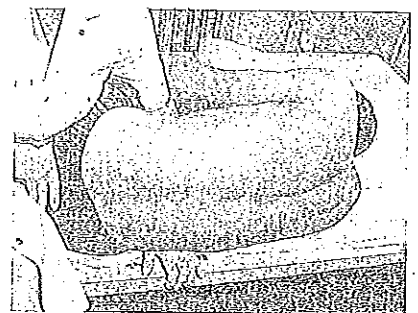


Fig.1.5.3. Pozitia asistentei 2 si a pacientului  
(in decubit lateral) pentru rahicenteza

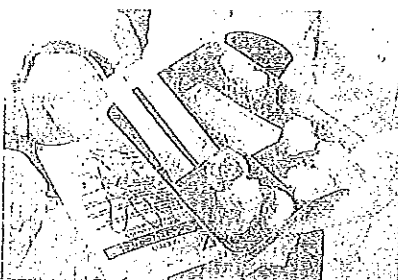



Fig.1.5.4. Materialele sanitare utilizate in  
rahicenteza




Fig.1.5.5. Pozitia pentru asistenta 1, asistenta 2  
si medic la inceputul rahicentei




Fig.1.5.6. Pozitia pentru asistenta 1, asistenta 2  
si medic la finalul rahicentei

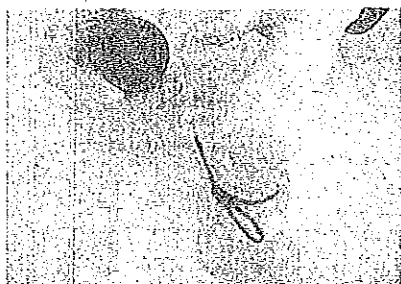


**Fig.1.6.1. Recipient refolosibil și de unică folosință pentru urocultură**

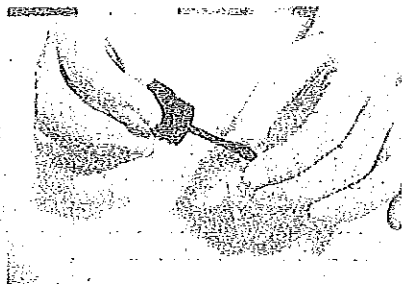


**Fig.1.7.1. Coprocolector pentru coprocultură (cu mediu)**

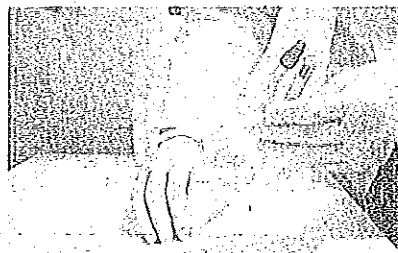


**Fig.2.2.1. Sonda vezicală - scoaterea din ambalaj cu asigurarea sterilității ei**

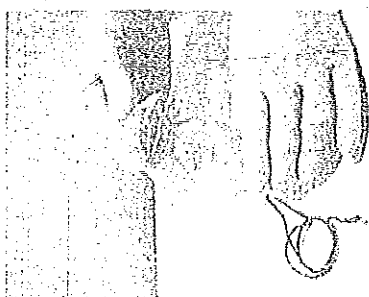

**Fig.1.6.2. Deschiderea corectă a recipientului refolosibil pentru urocultură**

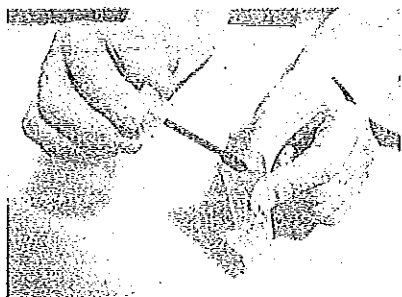

**Fig.1.7.2. Coprocolector pentru examen coproparazitologic (fără mediu)**

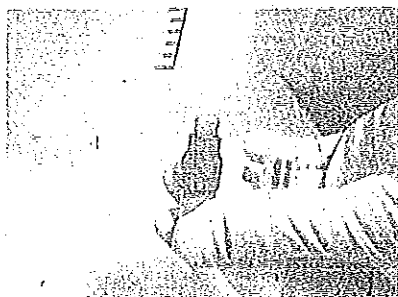

**Fig.2.2.2. Introducerea serului fiziologic pentru fixarea sondei în uretră**

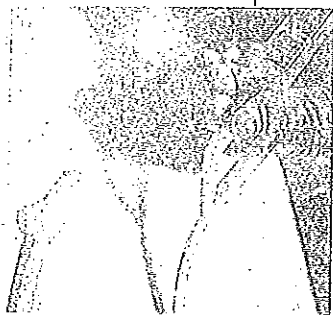


Fig.2.2.3. Exemplu de extensie a balonașului sondei vezicale prin injecție de ser fiziologic

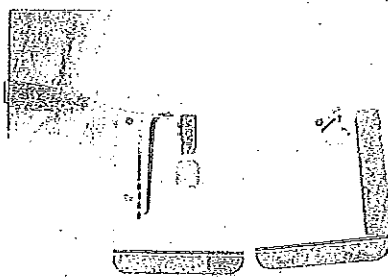


Fig.3.2.1. Introducerea sângelui în kit-ul de identificare rapidă a AgHBs/AgHBe



Fig.3.3.1. Introducerea serului în kit-ul de identificare rapidă a procaltitoninei



Fig.2.2.4. Atașarea sondei vezicale la punga colectoare pentru urină




Fig.3.2.2. Rezultat final al testului de identificare rapidă a AgHBs/AgHBe



Fig.3.3.2. Rezultat final cu kit-ul de identificare rapidă a procaltitoninei